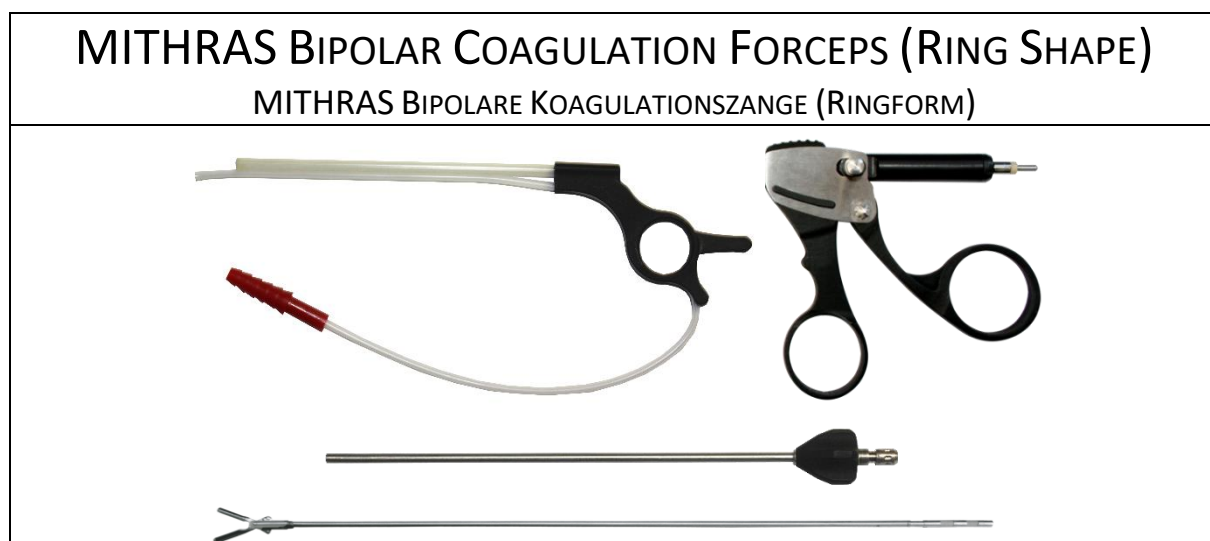


**MITHRAS Bipolar Coagulation Forceps (Ring Shape) with Suction Probe**



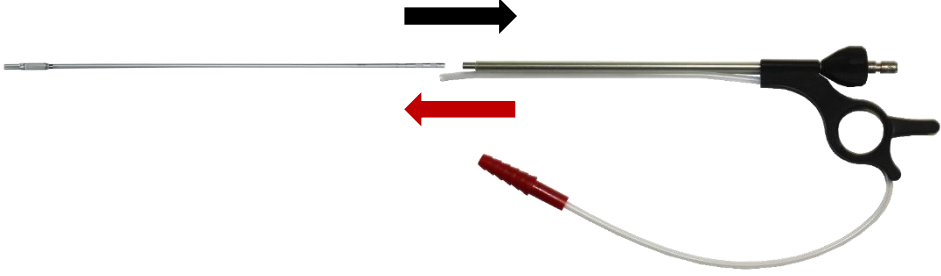
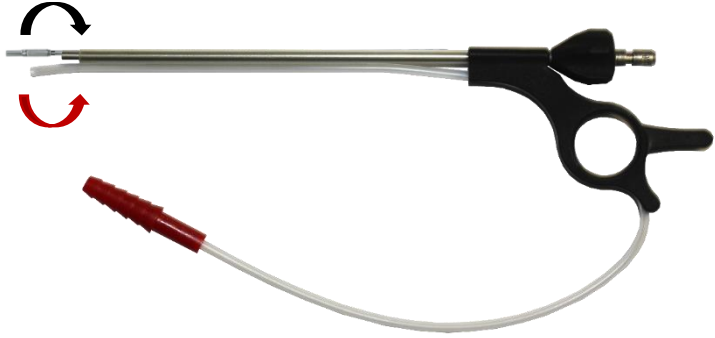
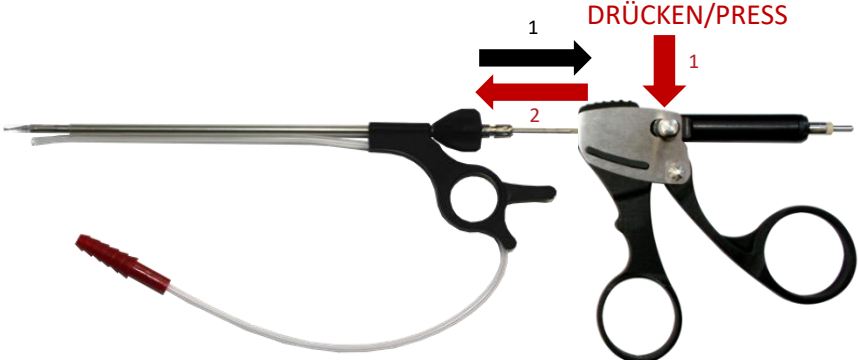
Dokumenten ID: **PIC-002 v1**  
 Bereich / Verantwortung: Produktmanagement  
 Prozesseigner:in: Produktmanager:in


<b>Erstellung / Bearbeitung</b>	Niklas Görner 07.03.2023 11:06:54
<b>Prüfung</b>	Digiser, Robin 14.06.2023 11:53:45
<b>Freigabe</b>	Schäfer, Michael 03.08.2023 10:17:46



**MONTAGEANWEISUNG / ASSEMBLY** ↓

Nr. / No.		Nr. / No.
<b>01</b>		<b>05</b>

<p>02</p>		<p>04</p>
<p>03</p>		<p>03</p>
<p>04</p>		<p>02</p>

05		01
Nr. / No.		Nr. / No.

DEMONTAGEANWEISUNG / DISASSEMBLY 